

МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ  
MAGUS METAL 630 | 630 BD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MAGUS



До начала работы на микроскопе необходимо внимательно прочитать данное руководство, изучить конструкцию, принцип действия, правила эксплуатации микроскопа, эксплуатационные ограничения и меры безопасности при использовании прибора.

В связи с постоянным усовершенствованием микроскопа в настоящем руководстве могут быть не отражены частичные конструктивные изменения, не влияющие на качество работы и правила эксплуатации.

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения удара электрическим током или возгорания отключайте питание микроскопа и отсоединяйте шнур питания из разъема перед сборкой микроскопа, заменой лампы или предохранителя.
2. За исключением съемных деталей, указанных в данном руководстве, нельзя разбирать микроскоп. Это может привести к разъюстировке. В случае неисправности обращайтесь в квалифицированный сервисный центр.
3. Проверяйте соответствие входного напряжения микроскопа напряжению местной сети электропитания. Неправильное входное напряжение может вызвать короткое замыкание или возгорание.
4. Использование неподходящей лампы, предохранителя или шнура электропитания может привести к повреждению или возгоранию микроскопа. Сетевой шнур должен быть заземлен.
5. Для предотвращения короткого замыкания или любых других неисправностей не подвергайте микроскоп воздействию высоких температур или среды с высокой влажностью в течение длительного времени.
6. Если на микроскоп попали брызги воды, отключите электропитание, отсоедините шнур электропитания, вытрите воду сухой тряпкой.
7. Лампа микроскопа во время работы нагревается. Во избежание ожогов не следует прикасаться к линзе коллектора и к самой лампе в течение 10 минут после выключения лампы. Для предотвращения пожара не следует размещать рядом с вентиляционными отверстиями на основании бумагу, горючие или взрывчатые материалы.
8. В микроскопе использован коаксиальный механизм грубой/тонкой фокусировки. Не следует поворачивать левую/правую рукоятки грубой/тонкой фокусировки в разных направлениях. При достижении предела перемещения нельзя продолжать вращать рукоятку грубой фокусировки.

9. Избегайте размещения микроскопа под прямыми солнечными лучами или в другом ярко освещенном месте. Не подвергайте микроскоп воздействию высоких температур, влажности или пыли, это может привести к запотеванию, плесени, загрязнению оптических деталей.
10. Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Используйте кисточку и специальные средства для чистки оптики.
11. Установка лампы:
- Не прикасайтесь голыми руками к стеклянной поверхности лампы. Во время установки лампы наденьте перчатки или оберните ее хлопчатобумажной тканью.
  - Стирайте грязь с поверхности лампы с помощью чистой хлопчатобумажной ткани, смоченной спиртом. Грязь может разъесть поверхность лампы, снизить ее яркость и сократить срок службы.
  - Проверьте контакт лампы. В случае повреждения контакта лампа может перестать работать или вызвать короткое замыкание.
  - Во время замены лампы ее цоколь следует как можно глубже вставить в патрон. Если цоколь вставлен неплотно, лампа может выскочить из патрона или вызвать короткое замыкание.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 ОПИСАНИЕ МИКРОСКОПА</b>	<b>5</b>
Назначение	5
Технические характеристики	5
Состав микроскопа	6
<b>2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ</b>	<b>8</b>
Корпус микроскопа	8
Фокусирувочный механизм	8
Визуальная насадка	8
Окуляры	8
Револьверное устройство	9
Объективы	9
Осветительная система отраженного света	9
Предметный столик	10
Фонарь лампы	10
Устройство простой поляризации	10
Светофильтры	10
<b>3 РАСПАКОВКА МИКРОСКОПА И УСТАНОВКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ</b>	<b>11</b>
<b>4 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ СВЕТЛОГО ПОЛЯ</b>	<b>12</b>
Включение освещения	12
Переключение канала визуализации	12
Настройка визуальной насадки	13
Центрировка источника света	13
Размещение объекта	14
Фокусировка на объект	14
Настройка освещения по Кёлеру	14
Использование светофильтров	15
Наблюдение в свете поляризации	15
Определение общего увеличения микроскопа	16
Определение поля зрения микроскопа	16
<b>5 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ ТЕМНОГО ПОЛЯ (MAGUS Metal 630 BD)</b>	<b>16</b>
<b>6 РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ</b>	<b>17</b>
Использование в работе окуляра с измерительной шкалой	17
Использование камеры	17
Использование калибровочного слайда при работе с камерой	18
<b>7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ</b>	<b>19</b>
<b>8 КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>	<b>20</b>
<b>9 ОБСЛУЖИВАНИЕ МИКРОСКОПА</b>	<b>21</b>
Замена лампы и предохранителя	21
Техническое обслуживание	22
<b>10 ГАРАНТИЯ MAGUS</b>	<b>23</b>

Микроскоп металлографический MAGUS Metal 630 (далее – микроскоп) сконструирован и испытан в соответствии с международными стандартами по технике безопасности. Микроскоп безопасен для здоровья, жизни, имущества потребителя и окружающей среды при правильной его эксплуатации. Правильное обслуживание микроскопа является необходимым условием его надежной и безопасной работы.

# 1 ОПИСАНИЕ МИКРОСКОПА

## НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов.

Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии.

Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля (MAGUS Metal 630 BD) и простой поляризации.

Микроскоп используется на предприятиях металлургической, машиностроительной, аэрокосмической, атомной и энергетической промышленности, в научно-исследовательских лабораториях и технических вузах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТАБЛ. 1)

	MAGUS Metal 630	MAGUS Metal 630 BD
Увеличение, крат	50–500 (1000, 1250, 1500, 2000, 2500)**	
Механическая длина тубуса микроскопа	Бесконечность (∞)	
Визуальная насадка	Посадочный диаметр окуляров – 30 мм Тринокулярная (тип Зидентопфа) Угол наклона визуальной насадки – 30° Межзрачковое расстояние: 48–75 мм Диоптрийная настройка на левом тубусе ±5 диоптрий	
Окуляры, увеличение, крат/ поле зрения, мм	10х/22 мм, удаленный зрачок – 10 мм 12,5х/14 мм*, 15х/15 мм*, 20х/12 мм*, 25х/9 мм* 10х/22 мм со шкалой* цена деления шкалы 0,1 мм	
Револьверное устройство	На 5 объективов	
Тип коррекции объективов	Планахроматы, скорректированные на длину тубуса «бесконечность» (∞), парфокальная высота – 45 мм	
Объективы, метод контрастирования	Светлое поле	Темное поле
Объективы увеличение, крат/апертура/ рабочее расстояние, мм	PL L 5х/0,12 WD: 26,1 мм	PL L 5х/0,12 BD WD: 9,7 мм
	PL L 10х/0,25 WD: 20,2 мм	PL L 10х/0,25 BD WD: 9,3 мм
	PL L 20х/0,40 WD: 8,8 мм	PL L 20х/0,40 BD WD: 7,2 мм
	PL L 50х/0,70 WD: 3,7 мм	PL L 50х/0,70 BD WD: 2,5 мм
	PL L 40х/0,60 WD: 3,9 мм*	PL L 40х/0,60 BD WD: 3,0 мм*
	PL L 60х/0,70 WD: 2,1 мм*	PL L 60х/0,70 BD WD: 1,9 мм*
	PL L 80х/0,80 WD 1,2 мм*	PL L 80х/0,80 BD WD: 0,8 мм*
	PL L 100х/0,85 (сухой) WD: 0,4 мм*	PL L 100х/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм*
Предметный столик	Двухкоординатный механический предметный столик Размер столика: 185 x 140 мм Диапазон перемещения: 35 x 30 мм Размер основания микроскопа: 300 x 235 мм	

Механизм фокусировки	Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены с двух сторон Цена деления тонкой фокусировки – 2 мкм Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки	
Способ освещения	Отраженный свет	
Осветительная система	Встроенные полевая и апертурная диафрагмы Встроенный анализатор и съемный поляризатор Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий	Устройство для работы по методу темного поля Встроенные полевая и апертурная диафрагмы Встроенный анализатор и съемный поляризатор Светофильтры: матовый, желтый, зеленый, синий
Источник света	Галогенная лампа 12 В/30 Вт с регулируемой яркостью	Галогенная лампа 12 В/50 Вт с регулируемой яркостью
Источник питания, В/Гц	Сеть переменного тока 220±22/50	
Диапазон рабочих температур	+5...+35 °С	
Диапазон рабочей влажности	20...80 %	
Габаритные размеры без упаковки (ШхВхД)	345 x 380 x 415 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхД)	374 x 730 x 394 мм	
Масса микроскопа	16,0 кг	
Масса микроскопа в упаковке	19,5 кг	

\* Не входит в комплект, поставляется по доп. заказу.

\*\* Достижение значения параметра возможно при использовании дополнительных окуляров и объективов.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.


## СОСТАВ МИКРОСКОПА

В состав микроскопа входят следующие основные части:

- штатив с основанием и предметным столиком;
- корпус микроскопа с механизмом фокусировки и револьвером объективов;
- насадка осветителя отраженного света;
- тринокулярная визуальная насадка;
- фонарь лампы;
- комплект объективов и окуляров;
- блок питания;
- комплект запасных частей и принадлежностей;
- упаковка;
- руководство по эксплуатации.

Полный состав микроскопа указан в разделе 8 данного руководства по эксплуатации.

Общий вид микроскопа представлен на рис. 1.

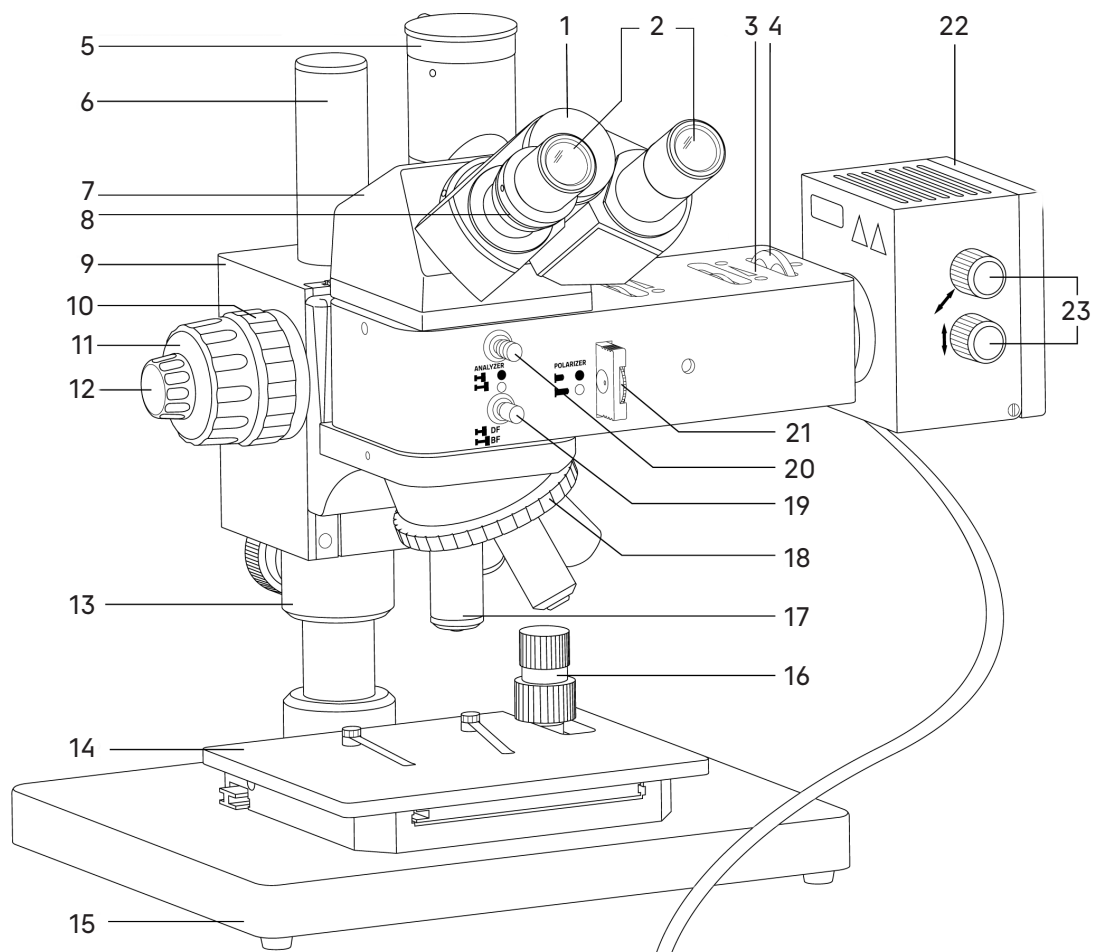

1. Кольцо маркировки межзрачкового расстояния
2. Окуляры
3. Насадка осветителя отраженного света
4. Набор цветных фильтров
5. Вертикальный тубус с каналом визуализации
6. Штатив
7. Визуальная насадка
8. Кольцо механизма диоптрийной подвижки
9. Корпус микроскопа
10. Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки
11. Рукоятка грубой фокусировки
12. Рукоятка тонкой фокусировки
13. Фиксирующее кольцо
14. Предметный столик
15. Основание микроскопа
16. Рукоятка перемещения предметного столика в двух взаимно-перпендикулярных направлениях
17. Объективы
18. Револьвер объективов

19. Рукоятка переключения темного поля (MAGUS Metal 630 BD)
20. Анализатор
21. Поляризатор
22. Фонарь
23. Рукоятки центровки лампы
24. Выключатель питания
25. Рукоятка регулировки яркости

Рис. 1. Микроскоп MAGUS Metal 630

## 2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

### КОРПУС МИКРОСКОПА

Корпус микроскопа 9 (рис. 1) установлен на штативе 6 (рис. 1), закрепленном на основании 15 (рис. 1).

Внутри корпуса расположен механизм фокусировки.

На передней стенке корпуса микроскопа закреплен кронштейн, на который устанавливаются револьвер объективов 17 (рис. 1) и насадка осветителя отраженного света 3 (рис. 1).

### ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Фокусируемый механизм размещен в корпусе микроскопа. Механизм имеет коаксиальную конструкцию – грубая и тонкая фокусировки, регулировка жесткости хода находятся на одной оси.

Фокусировка на объект осуществляется перемещением по высоте револьверного устройства. Грубая фокусировка производится вращением рукоятки 11 (рис. 1).

Тонкая фокусировка производится вращением рукоятки 12 (рис. 1). Тонкая фокусировка требуется для более точного фокусирования на объект и для подфокусировки микроскопа на резкость изображения при смене объективов и препаратов. Цена деления тонкой фокусировки – 2 мкм.

Механизм регулировки жесткости хода грубой фокусировки 10 (рис. 1) – кольцо между корпусом и рукояткой грубой фокусировки с левой стороны. С помощью кольца регулируется жесткость хода грубой фокусировки так, чтобы жесткость была комфортной для пользователя, но при этом револьвер не опускался самопроизвольно во время работы.

**Во избежание поломки механизма фокусировки:**

- не поворачивайте рукоятки грубой/тонкой фокусировки с левой/правой стороны в противоположных направлениях;
- не вращайте механизм грубой фокусировки после того, как механизм достиг своего предельного положения.

### ВИЗУАЛЬНАЯ НАСАДКА

Тринокулярная визуальная насадка 7 (рис. 1) обеспечивает визуальное наблюдение изображения объекта.

Визуальная насадка устанавливается на насадку осветителя отраженного света 3 (рис. 1) и закрепляется винтом.

Изменение межзрачкового расстояния в насадке осуществляется разворотом окулярных тубусов в пределах 48–75 мм. Значение расстояния, установленного в соответствии с глазной базой наблюдателя, отсчитывается по шкале на насадке.

Для удобной работы на микроскопе угол наклона визуальной насадки составляет 30°.

Посадочный диаметр окуляров – 30 мм.

Один из тубусов имеет механизм диоптрийной подвижки окуляров 8 (рис. 1) для компенсации аметропии глаз наблюдателя.

В вертикальный тубус 5 (рис. 1) корпуса визуальной насадки (канал визуализации) с помощью переходника C-mount устанавливается система визуализации с монитором. Переключение светового потока на вертикальный тубус производится рукояткой, расположенной на правой стенке корпуса микроскопа (не показано на рис. 1). Рукоятка имеет два положения: 100/0 и 0/100.

### ОКУЛЯРЫ

В комплект микроскопа входят окуляры 2 (рис. 1). Окуляры имеют высокое положение выходного зрачка и предназначены для работы как в очках, так и без них.

Посадочный диаметр окуляров – 30 мм.

Увеличение окуляров – 10х. Поле зрения – 22 мм. Удаленный зрачок – 10 мм.

Окуляр 10х со шкалой с ценой деления 0,1 мм, окуляры 12,5х/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм не входят в стандартный комплект и приобретаются дополнительно.

## РЕВОЛЬВЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

Револьверное устройство 18 (рис. 1) обеспечивает установку пяти объективов 17 (рис. 1). Смена объективов производится вращением револьверного устройства за конусную рифленую поверхность до фиксированного положения.

**Не следует вращать револьвер, держась за объективы.**

Вращение производится как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Револьверное устройство установлено на нижней стенке осветителя микроскопа. Объективы вворачиваются в револьверное устройство в порядке возрастания увеличения по часовой стрелке. Для удобства работы на микроскопе объективы повернуты «от наблюдателя».

## ОБЪЕКТИВЫ

Объективы рассчитаны на длину тубуса «бесконечность». Парфокальная высота объективов составляет 45 мм, линейное поле зрения в плоскости изображения – 22 мм. Объективы длиннофокусные.

Корпус каждого объектива имеет гравировку – тип коррекции «PL L» или «PL L BD», линейное увеличение, числовая апертура, длина тубуса «∞», цветовая маркировка, соответствующая увеличению в соответствии с международным стандартом.

Характеристики объективов (таблица 2):

Обозначение объектива	Метод исследования	Увеличение	Числовая апертура	Рабочее расстояние, мм	Цветовая маркировка
PL L 5x/0,12	Светлое поле	5x	0,12	26,1	Красная
PL L 5x/0,12 BD	Темное поле Светлое поле	5x	0,12	9,7	Красная
PL L 10x/0,25	Светлое поле	10x	0,25	20,2	Желтая
PL L 10x/0,25 BD	Темное поле Светлое поле	10x	0,25	9,3	Желтая
PL L 20x/0,40	Светлое поле	20x	0,40	8,8	Зеленая
PL L 20x/0,40 BD	Темное поле Светлое поле	20x	0,40	7,2	Зеленая
PL L 50x/0,70	Светлое поле	50x	0,70	3,7	Голубая
PL L 50x/0,70 BD	Темное поле Светлое поле	50x	0,70	2,5	Голубая

**В случае повреждения объективов их ремонт рекомендуется производить в сервисном центре.**

**Объективы рассчитаны на работу с воздушной средой. Иммерсионное масло использовать нельзя.**

## ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Осветительная система микроскопа позволяет настроить освещение по Кёлеру.

Источник света – галогенная лампа 30 Вт (MAGUS Metal 630) или галогенная лампа 50 Вт (MAGUS Metal 630 BD) – центрируется по трем осям.

На корпус микроскопа устанавливается насадка осветителя отраженного света 3 (рис. 1), в которую встроены полевая и апертурная диафрагмы. Полевая диафрагма также центрируется при помощи центрировочных винтов. Раскрытие/закрытие диафрагм производится вращением колец на верхней стенке насадки осветителя отраженного света (не показано на рис. 1).

## **ПРЕДМЕТНЫЙ СТОЛИК**

Двухкоординатный механический предметный столик 14 (рис. 1) закреплен на основании микроскопа.

Перемещение столика осуществляется рукоятками 16 (рис. 1).

Размеры столика: 185 x 140 мм. Диапазон перемещения: 35 x 30 мм.

## **ФОНАРЬ ЛАМПЫ**

На боковой стенке насадки осветителя находится соединительный переходник. На него устанавливается фонарь галогенной лампы 22 (рис. 1).

Центрировка лампы осуществляется рукоятками 23 (рис. 1).

**Манипуляции по снятию фонаря лампы со штатива микроскопа необходимо выполнять только при отсоединенной от сети системы электропитания!**

**Во время работы фонарь лампы нагревается. Во избежание пожара запрещено накрывать фонарь, а также размещать лабораторную посуду, объекты исследования или другие элементы на его поверхности!**

## **УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ**

Для проведения наблюдений в поляризованном свете микроскоп оснащен устройством простой поляризации, которое включает в себя встроенный анализатор 20 (рис. 1) и съемный поляризатор 21 (рис. 1). Поляризатор вращается в диапазоне 0–360°.

## **СВЕТОФИЛЬТРЫ**

В комплект микроскопа входит круглая пластина со светофильтрами 4 (рис. 1). Пластина имеет 5 положений: желтый, зеленый, синий, матовый фильтры, а также свободное отверстие. Светофильтры помогают правильно настроить цветопередачу в зависимости от образца исследования, улучшить цветовой баланс и повысить контрастность и яркость изображения.

### 3 РАСПАКОВКА МИКРОСКОПА И УСТАНОВКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Процесс установки (монтажа) показан на рис. 2.

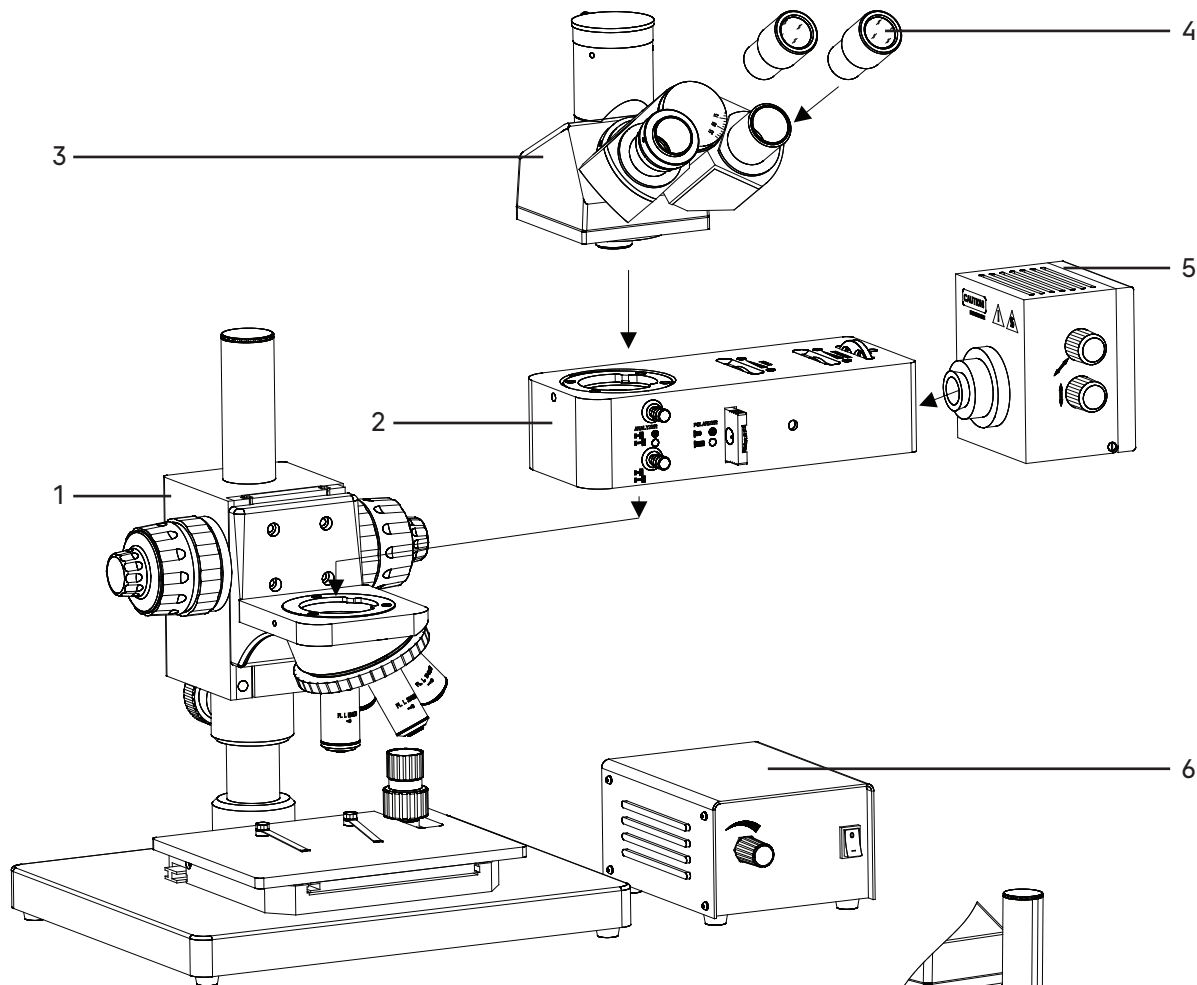


Рис. 2. Установка составных частей

1. Распакуйте микроскоп, проверьте состав микроскопа на соответствие комплектности, указанной в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.
2. Выньте штатив с основанием и корпусом 1 и поставьте его на устойчивый рабочий стол, уберите упаковочные элементы и пылезащитный чехол.  
Перед началом работы установите корпус на необходимую высоту. Для этого в соответствии с рис. 2b ослабьте рукоятку 2 втулки 1. Поднимите (опустите) втулку на нужную высоту. Ослабьте рукоятку 4 и переместите корпус 3 на верхнюю часть втулки.  
**Во избежание самопроизвольного опускания корпуса закручивайте рукоятки подъемного механизма до упора.**

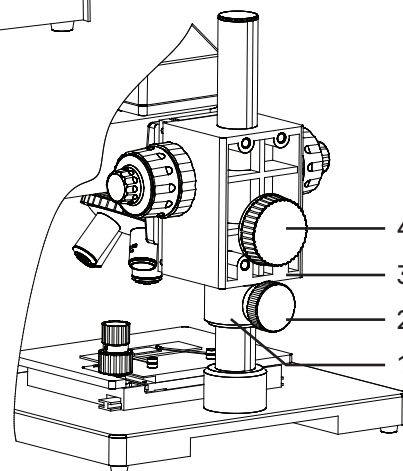


Рис. 2b. Регулировка высоты корпуса

3. Выньте насадку осветителя отраженного света **2** и фонарь лампы **5**. Установите насадку осветителя на кронштейн на корпусе микроскопа, зафиксируйте ее ключом-шестигранником. Установите фонарь лампы на осветитель и зафиксируйте винтом.
4. Выньте тринокулярную визуальную насадку **3** и окуляры **4**. Установите тринокулярную насадку на верхнюю стенку насадки осветителя, зафиксируйте. Вставьте окуляры в окулярные тубусы, поверните окуляры по окружности, убедитесь, что они плотно установлены в тубусы.
5. Достаньте блок питания **6** и подключите к нему шнур фонаря лампы. Подключите кабель питания..
6. Проверьте надежность и безопасность установки всех частей микроскопа.
7. Проверьте и отсортируйте в нужном порядке прилагаемые вспомогательные принадлежности и инструменты. Храните их в надлежащем порядке, чтобы избежать путаницы.
8. Сохраните упаковку на случай необходимости транспортировки микроскопа.

## 4 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ СВЕТЛОГО ПОЛЯ

### ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Прежде чем включить выключатель микроскопа, проверьте, совпадает ли входное напряжение питания микроскопа с местным напряжением сети. Если нет, не включайте микроскоп. Если на микроскоп подается несоответствующее входное напряжение питания, может возникнуть короткое замыкание или возгорание.

Переведите выключатель **1** в положение «|», чтобы зажечь галогенную лампу. Рукояткой **2** отрегулируйте яркость, чтобы она была комфортной для работы.

Не следует держать рукоятку регулировки яркости в положении максимальной яркости в течение длительного времени. Это может привести к сокращению срока службы лампы. Перед отключением микроскопа от сети убавьте накал горения лампы до минимума.

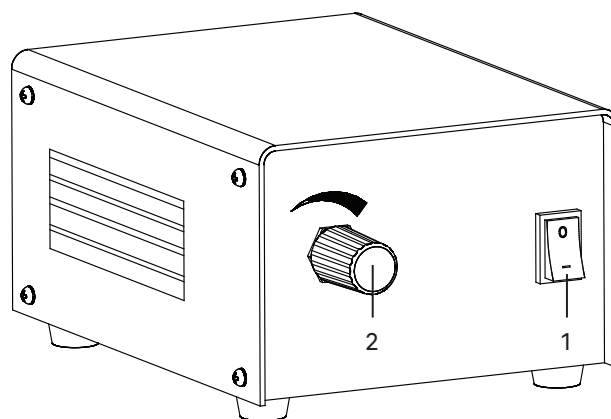


Рис. 3. Включение освещения и регулировка яркости горения лампы

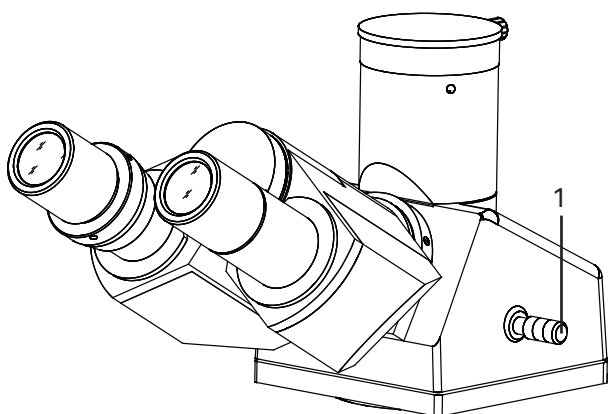


Рис. 4. Переключение канала визуализации

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Проверьте положение рукоятки переключения светового потока **1**.

Крайнее выдвинутое положение рукоятки означает переключение светового потока на канал визуализации.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

Поместите образец **3** на предметный столик **4** микроскопа. Отрегулируйте изображение рукоятками **1** и **2** так, чтобы наблюдаемый участок объекта был прямо под объективом.

Предметный столик имеет систему двухкоординатного перемещения. Рукоятки перемещения препарата коаксиальны – находятся на одной оси.

Рукоятка **2** контролирует продольное перемещение, рукоятка **1** – поперечное. Диапазон перемещения столика: 35 x 30 мм.

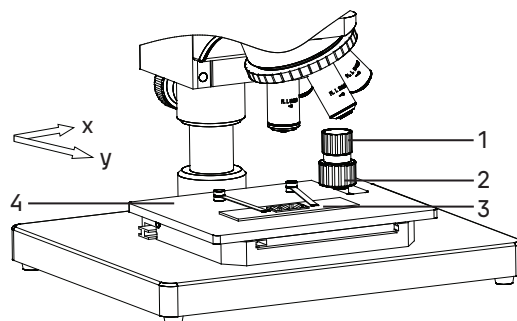


Рис. 5. Размещение объекта

## ФОКУСИРОВКА НА ОБЪЕКТ

Фокусировка на объект осуществляется ручками грубой и тонкой фокусировки.

Выполните фокусировку с использованием объектива 10x. Вращайте рукоятку грубой фокусировки **2**, чтобы поднять объектив до наивысшей точки. Опускайте объектив, глядя в окуляр и медленно поворачивая рукоятку фокусировки. Когда в поле зрения появится изображение объекта, остановите вращение рукоятки грубой фокусировки.

Вращайте рукоятку тонкой фокусировки **1**, чтобы сфокусироваться на объект и получить четкое изображение объекта.

Жесткость хода грубой фокусировки регулируется и заранее настраивается на заводе-изготовителе для удобства использования. Если необходимо отрегулировать жесткость хода рукоятки грубой фокусировки, поверните рукоятку регулировки жесткости хода **3**. Поворот по часовой стрелке уменьшает натяжение, поворот против часовой стрелки – увеличивает.

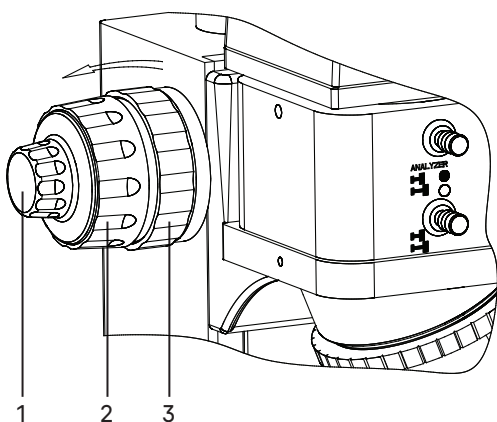


Рис. 6. Фокусировка на объект

## НАСТРОЙКА ВИЗУАЛЬНОЙ НАСАДКИ

Для компенсации аметропии глаз выставьте диоптрийную подвижку **1** на левом окулярном тубусе в положение «0», как показано на рис. 7.

Наблюдая в окуляр, установленный в правый окулярный тубус (при этом левый глаз закрыт), сфокусируйтесь на четкое изображение объекта. Наблюдая в окуляр, установленный в левый окулярный тубус (при этом правый глаз закрыт), и не трогая рукояток фокусировочного механизма, добейтесь резкого изображения объекта в левом окулярном тубусе вращением кольца диоптрийного механизма **1**.

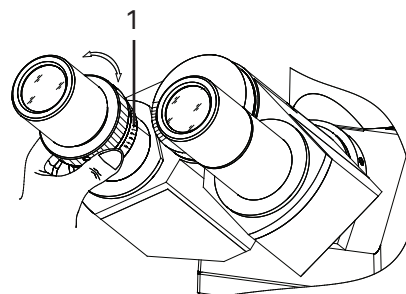


Рис. 7. Настройка механизма диоптрийной подвижки

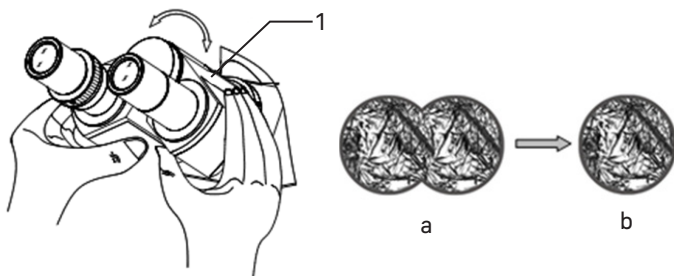


Рис. 8. Настройка межзрачкового расстояния

Отрегулируйте межзрачковое расстояние. Установите расстояние между осями окулярных тубусов насадки в соответствии с глазной базой наблюдателя поворотом окулярных тубусов **1** относительно оси шарнира таким образом, чтобы изображение объекта в каждом окуляре при наблюдении двумя глазами воспринималось наблюдателем как одно (рис. 8 а, b).

## ЦЕНТРИРОВКА ИСТОЧНИКА СВЕТА

Центр оптической системы источника света был откалиброван перед выпуском с завода-изготовителя.

Центрировка может быть нарушена во время транспортировки.

Центрировка источника света осуществляется следующим образом:

1. Кусок белой бумаги **2** (примерно 40 x 50 мм) положите на предметный столик и закрепите зажимами **1**, как показано на рис. 9а.
2. Выверните один из объективов из револьвера и введите в ход лучей свободное гнездо револьвера – отверстие без объектива, как показано на рис. 9б.
3. Откройте полевую и апертурную диафрагмы, в этот момент на белой бумаге появится яркое световое пятно с изображением нити накала внутри, как показано на рис. 9г.
4. Если изображение нити накала нечеткое, отрегулируйте положение коллектора при помощи рукоятки **7**.
5. Если изображение нити накала отклонено от центра светового пятна, отрегулируйте центр лампы рукояткой поперечного перемещения **5** и вертикального перемещения **6**.

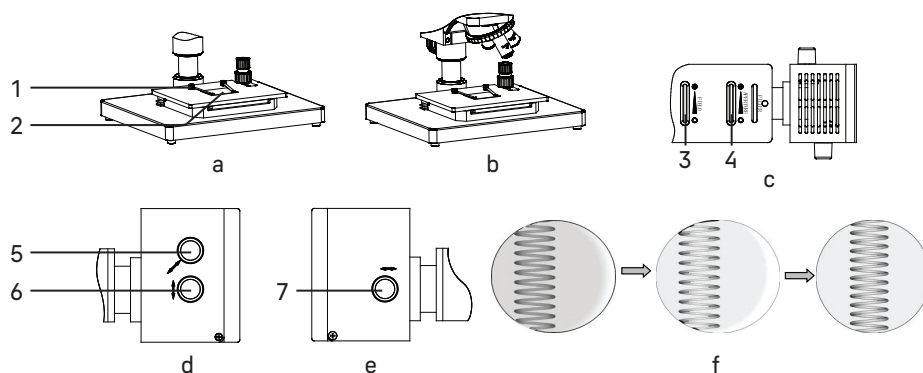


Рис. 9. Центрировка источника света

## НАСТРОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ ПО КЁЛЕРУ

При работе на световом оптическом микроскопе качество изображения в равной степени зависит от оптики и от осветительной системы микроскопа, поэтому настройка освещения является важной подготовительной операцией. Система освещения влияет на разрешение изображения, комфорт при длительной работе и качество фотографий при использовании цифровых камер.

Наличие освещения по Кёлеру является одним из признаков профессионального микроскопа. Правильная настройка освещения по Кёлеру дает следующие преимущества:

- максимально возможное разрешение на каждом объективе;
- фокусировка на изображение объекта исследования, при которой удаляются изображения артефактов: пыль на осветителе или на препарате, блики;
- однородность освещения всего поля зрения, отсутствие затемнений по краям.

Настройка освещения по Кёлеру производится следующим образом:

1. Поместите в оптическую ось объектив с увеличением 10х.
2. Откройте апертурную диафрагму **3** и закройте полевую диафрагму **1**, в поле зрения появится светлое пятно, как показано на рис. 10.
3. Если светлое пятно отклоняется от центра поля зрения, как показано на рис. 10а, отрегулируйте центрирующий винт **2** с помощью двух ключей-шестигранников, чтобы центр полевой диафрагмы совпал с центром поля зрения, как показано на рис. 10б.

4. Откройте полевую диафрагму, чтобы изображение наблюдаемого образца заполнило поле зрения, как показано на рис. 10с.

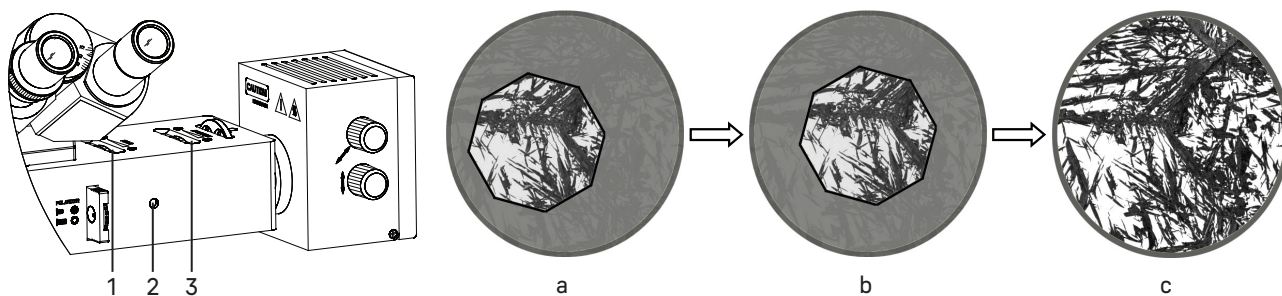


Рис. 10. Настройка освещения по Кёлеру

Центр апертурной диафрагмы 3 был откалиброван перед выпуском на заводе-изготовителе, поэтому ее центрирование не требуется. При использовании объектива с малым увеличением раскройте апертурную диафрагму в большую сторону, при использовании объектива с большим увеличением отрегулируйте апертурную диафрагму в меньшую сторону.

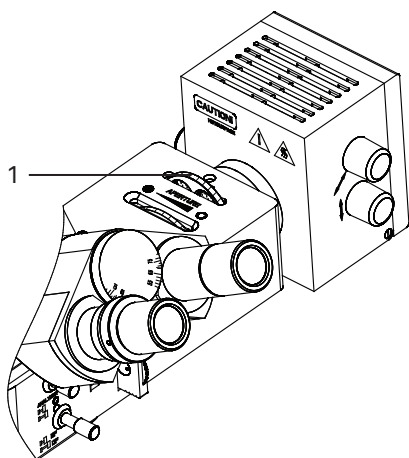


Рис. 11. Использование светофильтров

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Круглая пластина со светофильтрами установлена на верхней стенке осветителя отраженного света.

Выберите необходимый цвет светофильтра в зависимости от образца и метода исследования – светлое поле, темное поле (MAGUS Metal 630 BD) или метод простой поляризации.



Вращением пластины 1 установите соответствующее положение.

Правильно подобранный светофильтр позволяет сгладить оптические искажения.

## НАБЛЮДЕНИЕ В СВЕТЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Наблюдения в поляризованном свете проводят для изучения свойств двойного лучепреломления анизотропных материалов, например, кристаллов, биомедицинских полимеров и жидких кристаллов. Данный метод анализа широко используется в геологии, механике, металлургии, электронике.

В комплект микроскопа входит устройство простой поляризации, которое включает в себя поляризатор и анализатор.

Для наблюдений в свете поляризации введите поляризатор 2 и анализатор 1 в ход оптических лучей. Для этого установите поляризатор в положение , рукоятку анализатора – в положение . Вращением кольца выставьте поляризатор в такое положение, при котором поле зрения будет темным. Отрегулируйте яркость света, чтобы она была приближена к максимальной – в таком положении искомые фрагменты будут хорошо различимы.

Снижайте яркость после завершения наблюдений в свете поляризации. Длительное наблюдение при максимальной яркости может привести к нарушению зрения!

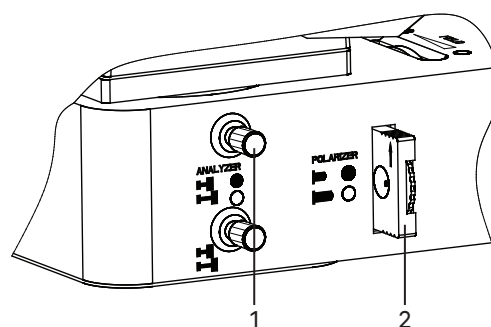


Рис. 12. Наблюдение в свете поляризации

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ МИКРОСКОПА

Общее увеличение микроскопа – это произведение увеличений объектива и окуляра.

Например, если окуляр 10х/22 мм, а объектив 50х/0,70, общее увеличение микроскопа  $10 \times 50 = 500x$ .

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ МИКРОСКОПА

Поле зрения микроскопа – это отношение поля зрения окуляра и увеличения объектива.

Например, если окуляр 10х/22 мм, а объектив 50х/0,70, поле зрения микроскопа  $22 \text{ мм} / 50x = 0,44 \text{ мм}$ .

Для точного определения поля зрения микроскопа используется объект-микрометр (калибровочный слайд).

# 5 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ ТЕМНОГО ПОЛЯ (MAGUS Metal 630 BD)

Металлографический микроскоп MAGUS Metal 630 BD позволяет проводить исследования как по методу светлого, так и по методу темного поля. Наблюдение в светлом поле производится согласно руководству по эксплуатации так, как описано выше. Дальнейшие инструкции относятся только для работы микроскопа по методу темного поля.

1. Выдвиньте рукоятку 2 положения светлого/темного поля в положение  $\blacksquare \text{DF}$ .
2. Выдвиньте рукоятку анализатора 3 в положение  $\blacksquare \text{O}$ , поляризатор 1 – в положение  $\blacksquare \text{O}$ . Устройство простой поляризации выведено из оптического пути.
3. Откройте полевую диафрагму 5 и апертурную диафрагму 6 на максимум.
4. Поместите образец или пробу на предметный столик. Отрегулируйте изображение рукоятками продольного и поперечного перемещения столика таким образом, чтобы наблюдаемый объект был прямо под объективом.
5. Сфокусируйтесь на четкое изображение объекта в темном поле. Если изображение в темном поле не наблюдается, переведите микроскоп в положение для наблюдения в светлом поле. После фокусировки на объект в светлом поле вернитесь к наблюдению в темном поле.
6. Если в поле зрения наблюдается асимметрия, следует отрегулировать рукоятки фокусировки коллекторной линзы 7 и регулировки положения лампы 8.

При наблюдении в темном поле диск регулировки яркости следует установить в максимальное положение.

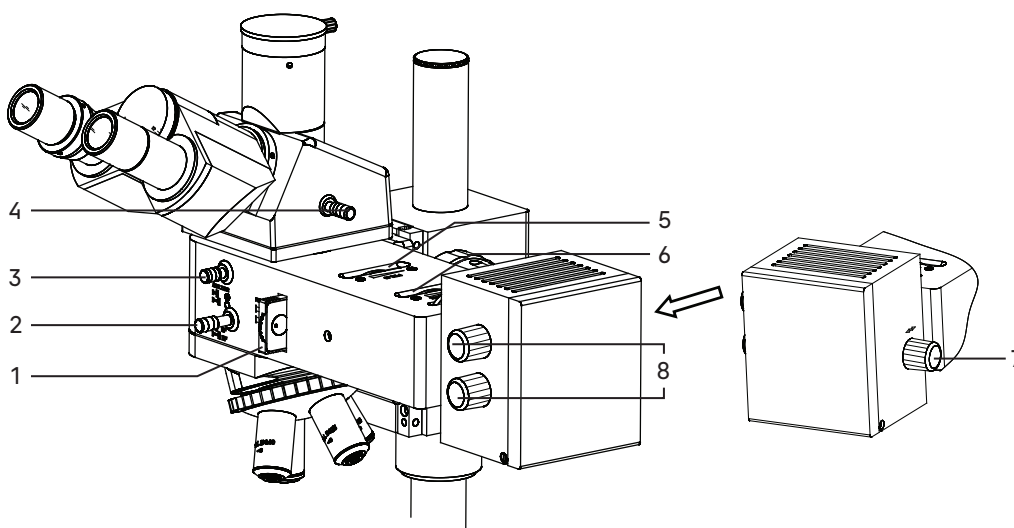


Рис. 13. Наблюдение в темном поле

## 6 РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ОКУЛЯРА С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ

Для выполнения сравнительных оценок линейных размеров отдельных составляющих объекта может быть применен окуляр со шкалой или с сеткой. Шкала установлена в плоскости полевой диафрагмы окуляра увеличением 10 крат. Окуляр со шкалой устанавливается в окулярный тубус вместо обычного окуляра.

Для определения размеров структур в линейной мере (в миллиметрах или микронах) необходимо воспользоваться специальной линейкой – объект-микрометром (калибровочным слайдом).

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с ценой деления 0,01 мм.

Калибровочный слайд положите на предметный столик вместо объекта шкалой вверх. По шкале калибровочного слайда произведите градуировку шкалы окуляра для каждого объектива, с которым будут выполняться измерения. Для этого сфокусируйте микроскоп на резкое изображение шкалы калибровочного слайда в плоскости шкалы окуляра и разверните окуляр в тубусе, установив штрихи обеих шкал параллельно. Определите, сколько делений калибровочного слайда укладывается в шкале окуляра (при объективах среднего и большого увеличения) или сколько делений шкалы окуляра занимает весь калибровочный слайд (при объективах малого увеличения).

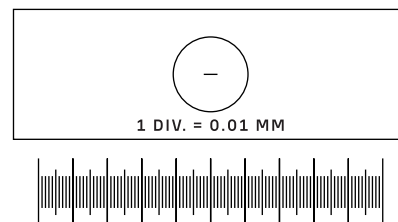


Рис. 14. Калибровочный слайд

Вычислите цену деления шкалы окуляра при работе с каждым объективом по формуле  $E=TL/A$ , где:

E – цена деления шкалы окуляра;

T – цена деления шкалы объект-микрометра, указанная на объект-микрометре (0,01 мм);

L – число делений объект-микрометра;

A – число делений шкалы окуляра.

Полученные данные рекомендуется записать в таблицу:

Увеличение объектива	Цена деления шкалы окуляра
5	
10	
20	
50	

Пользуясь этими данными, при определении истинной линейной величины объекта достаточно подсчитать число делений шкалы окуляра, наложенных на измеряемый участок объекта, и умножить это число на цену деления шкалы, указанную в данной таблице.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ

Конструкция микроскопа предусматривает наблюдение объекта через окуляры и фотографирование объекта. Микроскоп имеет вертикальный канал визуализации. Световой поток переключается 100/0 и 0/100. Переключение светового потока осуществляется рукояткой 4.

Важно правильно подобрать камеру для решения конкретных задач на микроскопе – работа на объективах малого или большого увеличения, в светлом поле или при использовании других методов контраста. Следует обращать внимание на светочувствительность, размер пикселя и сенсора, разрешение камеры и скорость передачи данных. Неправильно подобранная камера не позволит сделать качественные снимки, что приведет к искажению результатов исследования.

Для работы с камерой:

- Ослабьте крепежный винт 1, уберите пылезащитную заглушку 2.
- Соедините камеру с переходником C-mount из комплекта микроскопа.
- Установите камеру в канал визуализации 3 и закрепите винтом 1.

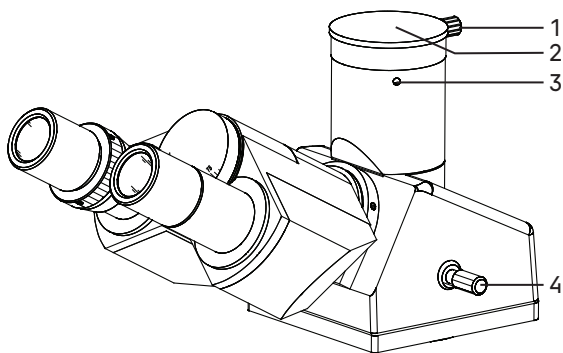


Рис. 15. Использование вертикального канала визуализации

- Введите в ход лучей объектив 10х. Наблюдая в окуляры, сфокусируйтесь на четкое изображение объекта.
- Включите камеру согласно инструкции, прилагаемой к камере.
- Выдвиньте рукоятку 4. Если изображение нечеткое, отрегулируйте фокус рукояткой тонкой фокусировки.

Если есть жесткое требование по синхронизации изображения в окулярах и камере (совпадение между центром и направлением изображения), необходимо отрегулировать канал визуализации. Вертикальный канал визуализации имеет три центрировочных винта.

Регулировка производится следующим образом:

- Установите рукоятку переключения светового потока 4 в положение для наблюдения через окуляры и камеру. Наблюдая объект через окуляры, найдите отличительную точку в поле зрения (легко идентифицируемую цель, такую как точка S на рис. 16а), переместите объект на предметном столике так, чтобы данная точка находилась в центре поля зрения как показано на рис. 16b. Для этой процедуры вместо обычного препарата удобно использовать специальный калибровочный слайд с перекрестьем, а вместо обычного окуляра – окуляр с перекрестьем.
- Посмотрите объект наблюдения на экране монитора или дисплея, проверьте, находится ли изображение идентифицируемой точки в центре поля зрения. Если изображение точки отклоняется от центра поля зрения, отрегулируйте три центрирующих винта на канале визуализации, чтобы сместить идентифицируемую точку к центру.
- Подвигайте образец и проверьте, переместилось ли изображение образца на мониторе или экране дисплея в том же направлении, что и перемещался образец. Если изображение сдвигается в другом направлении, необходимо отрегулировать положение камеры. Ослабьте крепежный винт 1, разверните камеру так, чтобы сделать отображаемое направление изображения в линию вдоль направления движения предметного столика, затем закрепите винт.

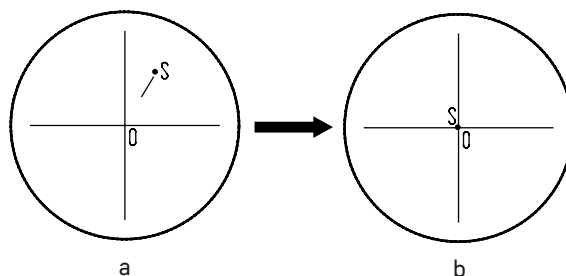


Рис. 16. Настройка канала визуализации

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВОЧНОГО СЛАЙДА ПРИ РАБОТЕ С КАМЕРОЙ

Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расстояний в реальных единицах. В режиме калибровки следует снять изображение микрометрической шкалы при каждом увеличении объектива микроскопа, указать известное расстояние. Таким образом задается масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т.д.). Калибровка:

1. Положите калибровочный слайд на предметный стол микроскопа.
2. Выберите рабочий объектив и установите максимальное разрешение камеры.
3. Получите на экране монитора контрастное изображение шкалы и снимите изображение.
4. Вызовите в используемой программе команду «Калибровка».
5. Укажите двумя щелчками мыши максимальное видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
6. Введите название калибровки и проверьте результат. Программа запомнит коэффициент.
7. В дальнейшем можно выбрать любую единицу измерения, все результаты будут пересчитываться в соответствии с этим выбором.

## 7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ

Возможные неисправности и способы их устранения (таблица 4):

Неисправность	Причина	Устранение
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>		
Отсутствует освещение в поле зрения	Выключатель электропитания не включен	Включить выключатель питания
	Повреждена галогенная лампа	Заменить галогенную лампу
	Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Плохой контакт электрической схемы	Проверить все разъемы. Отремонтировать с помощью профессионала-электронщика
	Установленная лампа не соответствует спецификации	Использовать соответствующую лампу
<b>ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>		
Присутствует черное затемнение по краю поля зрения, поле зрения неравномерно освещено	Револьвер объективов не повернут в фиксированное положение (объектив находится не в оптической оси)	Довернуть револьвер в фиксированное положение, т.е. поставить объектив в оптическую ось
	Диафрагма не отцентрирована или закрыта больше, чем следует для данного объектива	Отцентрировать диафрагму. Раскрыть диафрагму для освещения всего поля зрения
	Присутствует загрязнение объектива или окуляра	Убрать пыль с помощью специальной груши или кисточки. Протереть поверхность линз салфеткой, смоченной О-килолом
В поле зрения видна пыль	Присутствует пыль на линзе окуляра	Убрать пыль с помощью специальной груши или кисточки
Плохое качество изображения объекта (низкое разрешение, плохая контрастность)	Поврежден объектив	Отремонтировать объектив (с помощью профессионального специалиста) или заменить объектив
	Апертурная диафрагма слишком раскрыта	Отрегулировать раскрытие апертурной диафрагмы в соответствии с апертурой применяемого объектива
	Объектив отклонился от оптической оси	Повернуть револьвер в фиксированное положение
Фокальная плоскость изображения наклонена (ярче на одной стороне и темнее на другой)	Образец криво лежит на столике	Расположить образец плоско на предметном столике, устойчиво закрепить его в держателе объекта
<b>МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>		
Изображение не может оставаться четким во время наблюдения	Ослаблено кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки, в результате револьверное устройство самопроизвольно опускается	Правильно настроить механизм регулировки жесткости хода грубой фокусировки
	Корпус микроскопа самопроизвольно опускается	Закрепить корпус на необходимой высоте при помощи рукояток
Рукоятка грубой фокусировки вращается слишком туго	Слишком сильно затянуто кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки	Ослабить жесткость хода грубой фокусировки
Изображение объекта при наблюдении двумя глазами в двух окулярах не совпадают	Окулярные тубусы бинокулярной насадки не установлены по базе глаз наблюдателя	Правильно настроить визуальную насадку

## 8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полная комплектность (таблица 5)

Наименование изделия	Кол-во		Примечание
	MAGUS Metal 630	MAGUS Metal 630 BD	
<b>СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ</b>			
Штатив с основанием и предметным столиком	1	1	
Корпус микроскопа	1	1	
Насадка осветителя отраженного света	1	1	
Фонарь лампы	1	1	
Тринокулярная визуальная насадка	1	1	
Револьвер объективов	1	1	
Блок питания	1	1	
Устройство простой поляризации	1	1	
Слайдер со светофильтром	1	1	
<b>СМЕННЫЕ ЧАСТИ</b>			
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 5x/0,12 WD: 26,1 мм	1		
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 5x/0,12 BD WD 9,7 мм		1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 10x/0,25 WD: 20,2 мм	1		
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 10x/0,25 BD WD 9,3 мм		1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 20x/0,40 WD: 8,8 мм	1		
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 20x/0,40 BD WD 7,2 мм		1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 50x/0,70 WD: 3,7 мм	1		
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 50x/0,70 BD WD 2,5 мм		1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 40x/0,60 WD: 3,9 мм	1		Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 40x/0,60 BD WD 3,0 мм		1	Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 60x/0,70 WD: 2,1 мм	1		Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 60x/0,70 BD WD: 1,9 мм		1	Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 80x/0,80 WD: 1,2 мм	1		Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 80x/0,80 BD WD: 0,8 мм		1	Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 100x/0,85 (сухой) WD: 0,4 мм	1		Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 100x/0,85 (сухой) BD WD: 0,4 мм		1	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком	2	2	
Окуляр 10x/22 мм со шкалой	1	1	Поставляется по доп. заказу

Окуляр 12,5х/14 мм	2	2	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 15х/15 мм	2	2	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 20х/12 мм	2	2	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 25х/9 мм	2	2	Поставляется по доп. заказу
Адаптер C-mount для работы с камерой	1	1	
Наглазники окуляров	2	2	
Цифровая камера	1	1	Поставляется по доп. заказу
Монитор	1	1	Поставляется по доп. заказу
Калибровочный слайд	1	1	Поставляется по доп. заказу

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Винт фиксации визуальной насадки	1	1	
Набор ключей-шестигранников	1	1	
Отвертка	1	1	
Галогенная лампа 12 В/30 Вт	1		
Галогенная лампа 12 В/50 Вт		1	
Предохранитель	1	1	
Сетевой шнур питания для микроскопа	1	1	
Чехол	1	1	
Руководство по эксплуатации	1	1	

## 9 ОБСЛУЖИВАНИЕ МИКРОСКОПА

### ЗАМЕНА ЛАМПЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Перед заменой лампы или предохранителя переведите выключатель электропитания **1** в положение «0» (выключено). Отсоедините провод электропитания от розетки. Подождите примерно 30 минут, чтобы лампа остыла.

#### 1. Замена лампы

- Выньте шнур питания из гнезда;
- Ослабьте крепежный винт и откройте крышку корпуса насадки, как показано на рис. 17b;
- Извлеките неисправную лампу **2** и установите новую;

При установке лампы используйте салфетку.

Следы рук на корпусе сокращают срок службы лампы.

- Установите крышку на фонарь и закрепите винтом;
- Подключите шнур электропитания, переведите выключатель в положение «—»;
- Произведите центровку лампы, как описано выше.

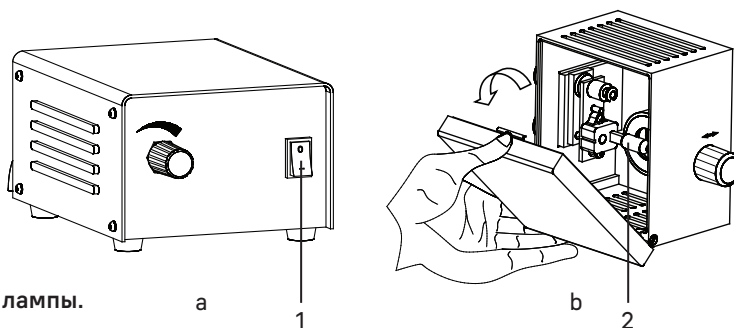


Рис. 17. Замена лампы

## 2. Замена предохранителя

Предохранитель встроен в гнездо. Заменяется следующим образом:

- ослабьте винт 1 гнезда предохранителя, извлеките поврежденный предохранитель и установите новый;
- подключите шнур электропитания и переведите выключатель в положение «→», чтобы проверить работоспособность предохранителя.

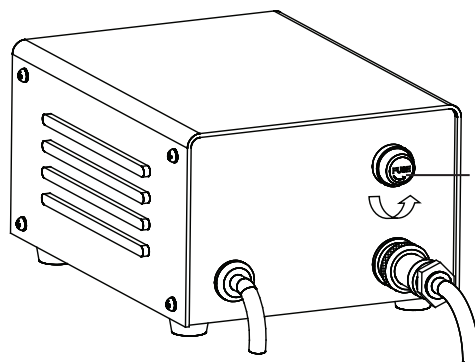


Рис. 18. Замена предохранителя

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При завершении работы на микроскопе отключите питание. Если микроскоп не предполагается к использованию в течение длительного периода, отключите его от сети.
2. Микроскоп должен находиться в чистом состоянии. Необходимо удалять любые следы масла на линзах, очищать корпус чистой марлей (шелковой или хлопчатобумажной тканью), смоченной небольшим количеством спирта. Не надевайте пылезащитный чехол, пока микроскоп полностью не остынет и не просохнет.

### 3. Очистка линз:

Удалите пыль на линзах с помощью мягкой кисточки. Существенное загрязнение можно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной небольшим количеством смеси спирта и этилового эфира (пропорция смеси: 20–30% спирта и 70–80% этилового эфира) или специальным раствором О-силола. Линзы протираются круговыми движениями от центра к краю.

4. Очистка поверхности микроскопа: протереть чистой мягкой тканью; значительное загрязнение можно стереть нейтральным моющим средством.

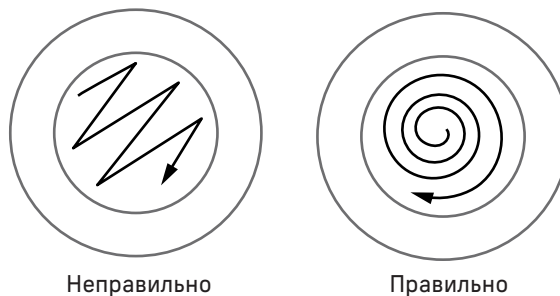


Рис. 19. Очистка линз

**Не протирайте штатив микроскопа с использованием какого-либо органического растворителя (например, спирта, этилового эфира или его разбавленного раствора). Это может вызвать повреждение поверхностной окраски штатива.**

5. Хранение: если микроскоп не предполагается использовать в течение длительного периода, отключите питание, дождитесь остывания лампы, установите пылезащитный чехол, храните микроскоп в сухом, вентилируемом и чистом месте, без воздействия кислот, щелочей или пара, иначе возможно образование плесени на линзах.

**Рекомендуется нанести слой антикоррозийной смазки на подвижные детали микроскопа.**

6. Периодическая проверка: микроскоп должен периодически проходить проверку и техническое обслуживание для поддержания его рабочих характеристик.

## 10 ГАРАНТИЯ MAGUS

Техника MAGUS обеспечивается **пятилетней международной гарантией** со дня покупки (действует в течение всего срока эксплуатации прибора). Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия MAGUS требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте [www.magusmicro.com](http://www.magusmicro.com)

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.



**MAGUS**

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

[www.magusmicro.ru](http://www.magusmicro.ru)